indusbello
inovação para uma vida saudável

Autoclavável em até 135º C

Linha Odontológica

Consultar Instruções de Utilização

Não Estéril

Manter Afastado da Luz do Sol

Manter Seco

Conjunto de Aspiração Endodôntico

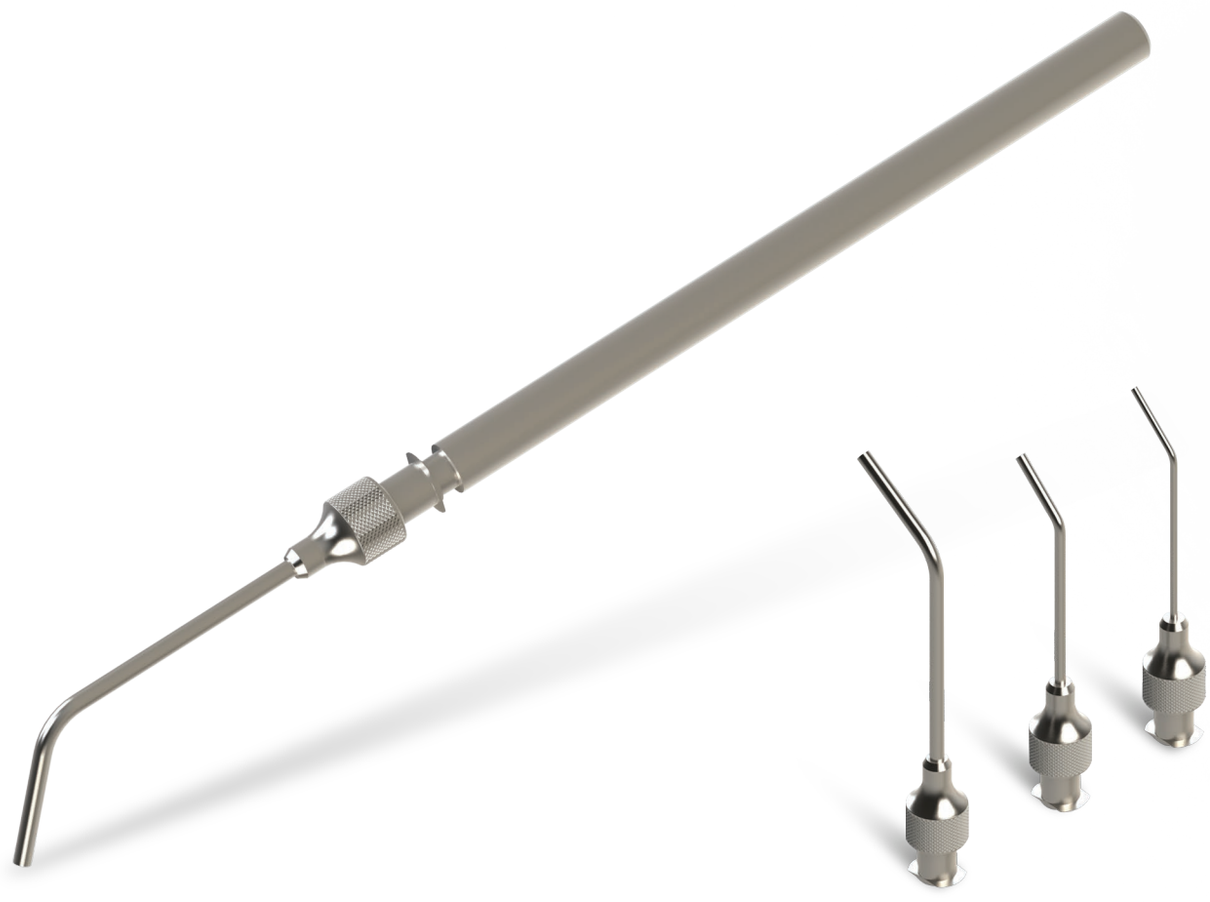

- 3 tamanhos de agulhas
- Tamanho da cânula permite perfeita empunhadura

Possui as curvaturas das agulhas compatíveis com a necessidade diária, facilitando a aspiração das soluções irrigadoras durante o tratamento de canal. O tamanho da cânula favorece a empunhadura e por ser lisa facilita a limpeza e remoção de detritos.

INDICAÇÕES: Aspiração de substâncias irrigadoras durante o tratamento de canal.

INSTRUÇÕES PARA USO: Encaixar a agulha de aspiração na cânula; Encaixar a cânula na mangueira do sugador que está acoplada ao equipo.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando detergente enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura 121ºC a 135ºC, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Aço inox.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código	Descrição	Apresentação	Registro da ANVISA
109010100304	*Conjunto de Apiração Endodôntico Autoclavável*	*3 Agulhas + 1 Cânula*	*II 80213420015*

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645
Indústria Brasileira

EC REP Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net